

添付文書改訂のお知らせ

2023年1月 株式会社ミズホメディー





この度、弊社製品の添付文書を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子化された添付文書をご参照くださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

記


マイコプラズマ核酸キット

スマートジーン® Myco 検体採取セット

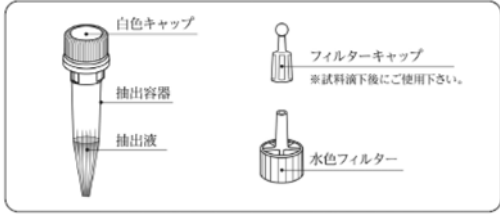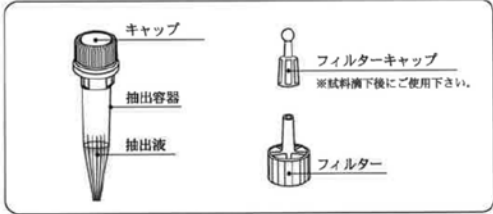改訂部分抜粋（_____改訂）


改訂後（2023年1月改訂 第6版）	改訂前（2021年6月作成 第5版）
【全般的な注意】	【全般的な注意】
3) <u>電子添文</u> 以外の使用方法については保証を致しません。	3) <u>添付文書</u> 以外の使用方法については保証を致しません。
5) 万が一、抽出液が誤って目や口に入ったり、皮膚に付いたりした場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。	5) 万が一、抽出液が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着したりした場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
6) 専用の「全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®」の使用に際しては、必ずその <u>電子添文</u> 及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。	6) 専用の「全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®」の使用に際しては、必ずその <u>添付文書</u> 及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。
【操作上の注意】	【操作上の注意】
7) 妨害物質・妨害薬剤 リンコマイシン <u>塩酸塩</u> (100 µg/mL) ジフェンヒドラミン <u>塩酸塩</u> (100 µg/mL)	7) 妨害物質・妨害薬剤 <u>塩酸</u> リンコマイシン (100 µg/mL) <u>塩酸</u> ジフェンヒドラミン (100 µg/mL)
【用法・用量(操作方法)】	【用法・用量(操作方法)】
● 抽出容器各部名称  ※キャップとフィルターの名称変更	● 抽出容器各部名称 
● 抽出検体の調製 	● 抽出容器各部名称 

●テストカートリッジ各部名称

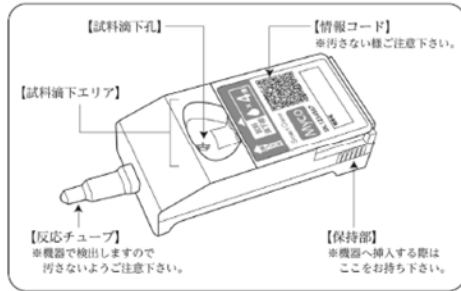

※テストカートリッジラベルデザイン変更

●テストカートリッジ各部名称

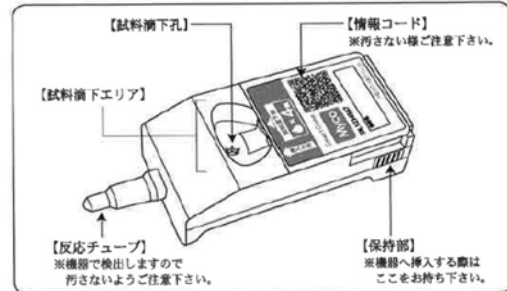

●操作方法

3) 測定操作法

①



※アルミ袋・テストカートリッジカバーデザイン変更


●操作方法

3) 測定操作法

①




②

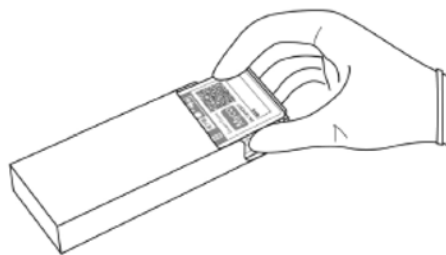


※テストカートリッジカバーデザイン変更

②

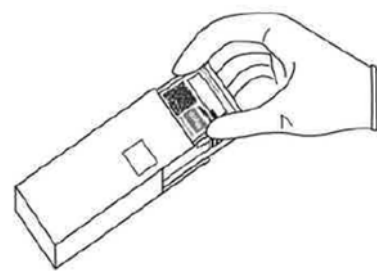


③

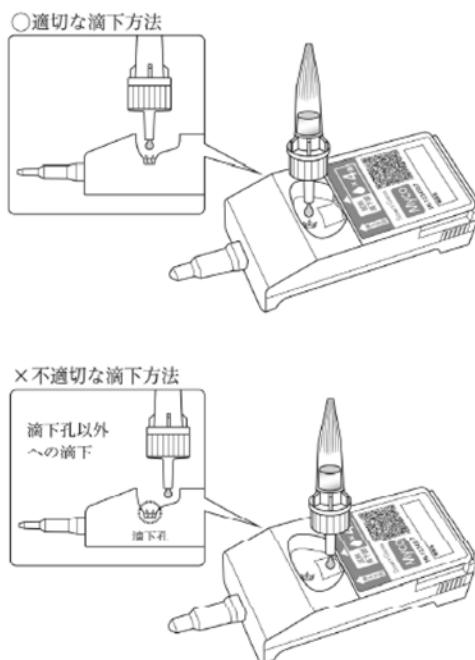

※テストカートリッジラベルデザイン変更


③

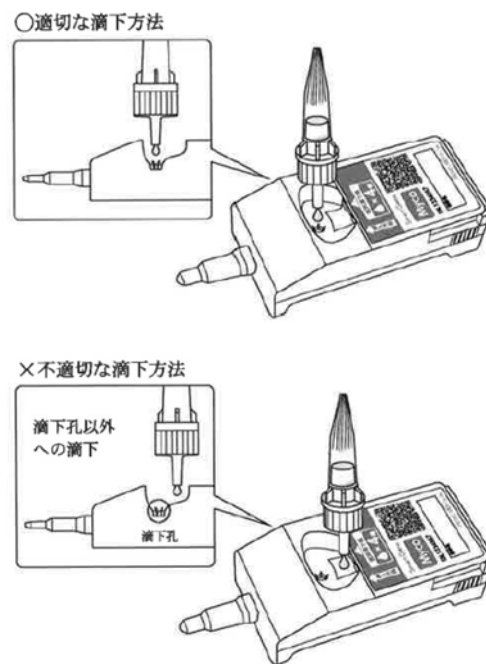

●操作方法

3) 測定操作法

③

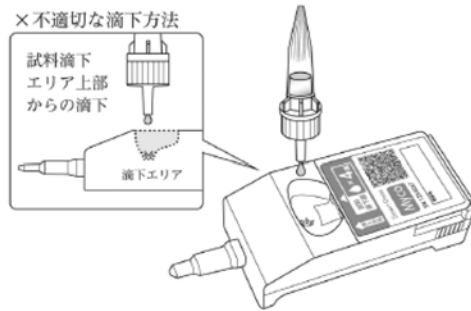


※テストカートリッジラベルデザイン変更

●操作方法

3) 測定操作法

③

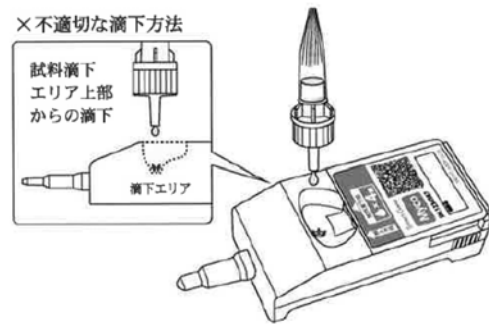

以上