

# 電子添文改訂のお知らせ

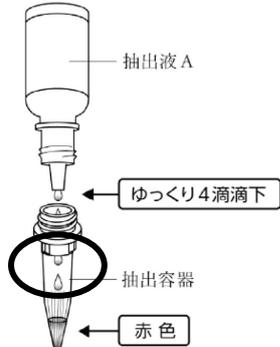
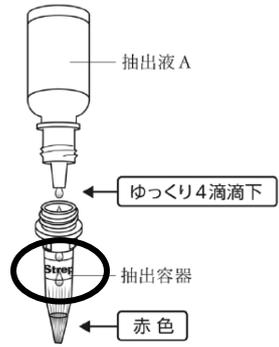
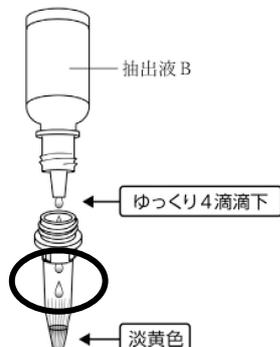
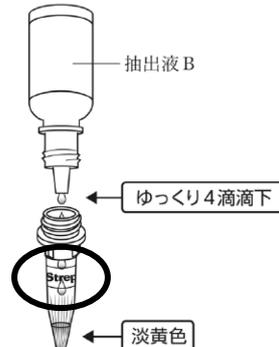
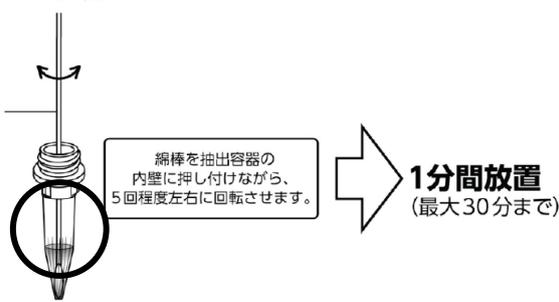
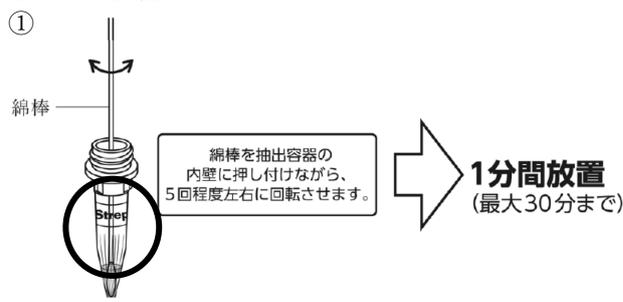
2025年8月 株式会社ミズホメディー


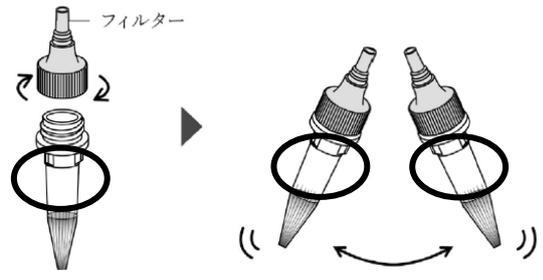
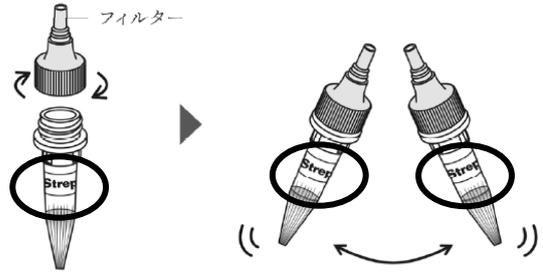
この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。  
 今後のご使用につきましては、改訂後の電子化された電子添文をご参照くださいますよう  
 宜しくお願い申し上げます。

記

## A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット クイック チェイサー® Auto Strep A

改訂部分抜粋（\_\_\_\_\_改訂）

改訂後(2025年8月改訂 第9版)	改訂前(2023年6月改訂 第8版)
<p><b>【用法・用量（操作方法）】</b></p> <p>●検体抽出液の調製</p> <p>①</p>  <p>イラストの変更</p>	<p><b>【用法・用量（操作方法）】</b></p> <p>●検体抽出液の調製</p> <p>①</p>  <p>イラストの変更</p>
<p>②</p>  <p>イラストの変更</p>	<p>②</p>  <p>イラストの変更</p>
<p>●試料の調製</p> <p>①</p>  <p>イラストの変更</p>	<p>●試料の調製</p> <p>①</p>  <p>イラストの変更</p>

改訂後(2025年8月改訂 第9版)	改訂前(2023年6月改訂 第8版)
<p>②</p>  <p>イラストの変更</p>	<p>②</p>  <p>イラストの変更</p>
<p>③</p> <p>フィルター</p>  <p>イラストの変更</p>	<p>③</p> <p>フィルター</p>  <p>イラストの変更</p>

以上